ResMed

S9™ Wireless Module

DATA TRANSFER ACCESSORY

User Guide

Español

B

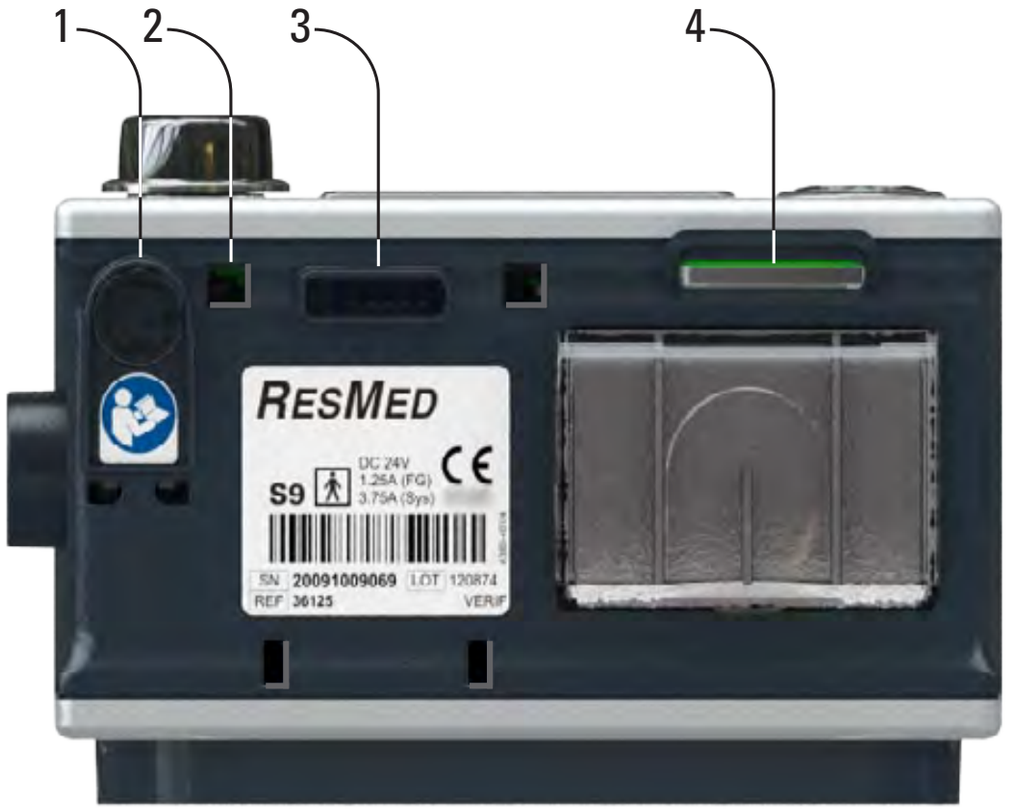
1
2
3
4
RESMED
S9
DC 24V
1.25A (FG)
3.75A (Sys)
SN 20091009069
LOT 120874
REF 36125
VERIF

Español

Le agradecemos que haya elegido el módulo inalámbrico del S9. El módulo inalámbrico del S9 sirve para utilizarlo con dispositivos S9 de ResMed con el fin de transmitir desde su domicilio los datos de tratamiento procedentes del dispositivo al profesional sanitario.

Antes de usar este dispositivo lea el presente manual en su totalidad.

El módulo inalámbrico del S9:

- envía los datos de tratamiento del paciente a un servidor centralizado al cual podrá acceder el profesional sanitario por internet; y
- recibe los cambios que haya que realizar a los parámetros del dispositivo S9 según las instrucciones enviadas por el profesional sanitario.

Módulo inalámbrico del S9

Consulte la ilustración A.

1. Conector del módulo
2. Pestaña del módulo
3. Luz indicadora del estado
4. Botón de liberación

Panel posterior del dispositivo S9

Consulte la ilustración B.

1. Entrada de alimentación CC
2. Cavidad para la pestaña del módulo
3. Puerto de adaptador/módulo
4. Ranura para tarjeta SD

Instalación

1. Desenchufe el dispositivo S9 de la toma de corriente.
2. Ponga las pestañas del módulo inalámbrico del S9 a la altura de las cavidades correspondientes e introduzca el módulo inalámbrico en el dispositivo S9 (consulte las ilustraciones C y D). Asegúrese de que las pestañas del módulo encajen en su sitio.
3. Vuelva a enchufar el dispositivo S9 a la toma de corriente. La luz indicadora del estado del módulo inalámbrico del S9 parpadeará lentamente (estará encendida durante 1 segundo, y luego apagada durante otro segundo).

Una vez finalizado el encendido, aparecerá en el dispositivo S9 la intensidad de la señal y la información de red. Dicha información aparece 5 veces durante 30 segundos cada vez. Si el profesional sanitario ya ha activado el módulo, la luz indicadora del estado dejará de parpadear y se encenderá de continuo. En el panel visor del S9 aparece la pantalla de espera. El módulo inalámbrico del S9 está listo para transmitir datos.

Nota: *No ponga encima, ni debajo ni cerca del módulo inalámbrico del S9 objetos susceptibles de inhibir la recepción (p. ej. televisores u ordenadores).*

Transmisión de datos

El módulo inalámbrico del S9 ha sido programado para que todos los días a una hora determinada transmita datos automáticamente desde su dispositivo S9.

Desacoplamiento y devolución del módulo inalámbrico del S9

1. Desenchufe el dispositivo S9 de la toma de corriente.
2. Mantenga pulsados los botones de liberación situados a cada lado del módulo inalámbrico del S9 y tire del mismo para separarlo del dispositivo S9.
3. Cuando se lo indique, devuelva al profesional sanitario la presente guía del usuario y el módulo inalámbrico del S9 dentro de su embalaje original.

Limpieza y mantenimiento

Si es necesario, pase un trapo limpio y seco al exterior del módulo inalámbrico del S9.

Conserve el embalaje

Conserve la presente guía del usuario y todo el embalaje original del módulo inalámbrico del S9.

Solución de problemas

Si hay un problema, intente las siguientes sugerencias. Si no se puede resolver el problema, póngase en contacto con el profesional sanitario.

Problema/causa posible	Solución
El indicador del módulo inalámbrico del S9 parpadea rápidamente (dos veces por segundo).	
El módulo inalámbrico del S9 no puede establecer la comunicación con el dispositivo S9 al que está acoplado.	Desacople el módulo inalámbrico del S9 del dispositivo S9 siguiendo las instrucciones. Vuelva a acoplar el módulo inalámbrico del S9 y vuelva a enchufar el dispositivo S9 a la toma de corriente. Si no se ha solucionado el problema, póngase en contacto con el profesional sanitario.
No se enciende la luz indicadora del módulo inalámbrico del S9.	
Es posible que no se haya conectado correctamente el módulo inalámbrico del S9 al dispositivo S9, o no se ha encendido este último.	Desacople el módulo inalámbrico del S9 del dispositivo S9 siguiendo las instrucciones. Vuelva a acoplar el módulo inalámbrico del S9 y vuelva a enchufar el dispositivo S9 a la toma de corriente. Si no se ha solucionado el problema, póngase en contacto con el profesional sanitario.
La luz indicadora del módulo inalámbrico del S9 comienza el parpadeo lento y no sale de tal estado (sigue parpadeando pasados 10 minutos de su encendido).	
El profesional sanitario no ha activado el módulo inalámbrico del S9.	Si no se ha resuelto el problema en unos días, póngase en contacto con el profesional sanitario.

Problema/causa posible	Solución
Señal de red insuficiente. 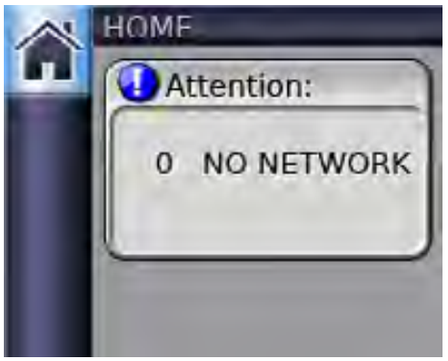	Desenchufe el dispositivo S9 y vuelva a enchufarlo a la toma de corriente. Compruebe la intensidad de la señal que aparece en el panel visor del dispositivo S9. La intensidad de la señal indicada se encuentra entre el 1 y el 5, donde “1” es una intensidad muy baja y “5” es una intensidad excelente. Asegúrese de que no hay ningún objeto que pueda inhibir la recepción cerca del módulo inalámbrico del S9 (p. ej. televisores u ordenadores). Si no se ha solucionado el problema, póngase en contacto con el profesional sanitario.

Especificaciones técnicas

Temperatura de funcionamiento	+5° C a +35 °C
Humedad de funcionamiento	10 a 95% sin condensación
Temperatura de almacenamiento y transporte	-20 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento y transporte	10 a 95% sin condensación
Dimensiones totales (L x An x Al)	39,60 mm x 54,10 mm x 125,0 mm
Peso	< 100 g
Compatibilidad electromagnética	Para obtener más detalles consulte la Guía de información del S9.

Nota: *el fabricante se reserva el derecho a cambiar estas especificaciones sin previo aviso.*

Símbolos que aparecen en el producto

Pueden aparecer los siguientes símbolos en el módulo inalámbrico del S9 o en el embalaje:

Precaución; Leer las instrucciones antes de usar; IP21 Protección contra inserción de dedos y goteo vertical de agua; Fabricante; LOT Código de lote; RoHS Directiva europea RoHS; REF Número de catálogo; SN Número de serie; Asociación normativa Canadian Standards Association; Con certificado UL; Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.; Radiación no ionizante; EC REP Representante autorizado en la UE.

Información medioambiental

La WEEE 2002/96/CE es una directiva europea que exige la correcta eliminación de equipos eléctricos y electrónicos. Estos dispositivos deberán ser eliminados por separado y no en la basura municipal sin clasificar. Para desechar su dispositivo, debe hacer uso de los sistemas correspondientes de recogida de basura, reutilización y reciclaje que haya disponibles en su región. El uso de estos sistemas de recogida de basura, reutilización y reciclaje tiene por objeto reducir la presión sobre los recursos naturales e impedir que sustancias peligrosas dañen el medio ambiente.

Si necesita información sobre estos sistemas de eliminación, póngase en contacto con la administración de basura de su región. El símbolo de cubo de basura tachado le invita a usar estos otros sistemas de eliminación. Si necesita información para la recogida y eliminación de su dispositivo de ResMed, póngase en contacto con la oficina de ResMed más cercana o con su distribuidor local, o visite la página www.resmed.com/environment.

⚠ ADVERTENCIAS

- Peligro de electrocución. No sumerja el dispositivo ni el cable de alimentación en agua.
- Desenchufe siempre el dispositivo antes de limpiarlo, y asegúrese de que esté seco antes de enchufarlo de nuevo.
- No abra el módulo inalámbrico del S9. En su interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Las reparaciones y el mantenimiento interno deberán ser efectuados únicamente por un agente de servicio autorizado.

⚠ PRECAUCIÓN

- En los EE.UU., la ley federal exige que este equipo sea vendido únicamente por un médico o por su orden.
- Solo utilice el módulo inalámbrico del S9 como se indica en esta guía.
- Evite exponer el módulo inalámbrico del S9 a la humedad o a temperaturas extremas.
- No utilice líquidos para la limpieza de ninguna de las partes del dispositivo.

Garantía limitada

Consulte la Guía de información del S9 de ResMed.

Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia.

Distributed by: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA.

EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK.

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

S9 and ResScan are trademarks of ResMed Ltd and S9 is registered in U.S. Patent and Trademark Office.

CE 0682

C

D

© 2012 ResMed Ltd. 368797-Spa/1 2012-03